



STYRELSEN FOR  
PATIENTSIKKERHED



Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67  
2300 København S  
E-mail: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)  
Tlf.: +45 7228 6600

[www.stps.dk](http://www.stps.dk)

Oktober 2018



STYRELSEN FOR  
PATIENTSIKKERHED




# Gode råd om sikker håndtering af materialer på tandklinikken




# Gode råd om sikker håndtering af materialer på tandklinikken

Sikker materialehåndtering er vigtig for patientsikkerheden på tandklinikker. Hvis materialer forveksles eller har overskredet holdbarhedsdatoen, kan det have konsekvenser for patientsikkerheden. Med nogle enkle metoder kan klinikken sikre sig, at der ikke opstår tvivl om indhold eller holdbarhed af de materialer, der opbevares på klinikken. Det gælder fx calciumhydroxid, der anvendes ved rodbehandlinger for at fjerne bakterier og phosphorsyre, som bruges til plastbehandling.


De fleste materialer er fra producentens side forsynet med en mærkat eller label, der beskriver indhold, holdbarhed og krav til opbevaring. Men når man på klinikken tager materialer eller produkter ud af originalemballagen eller på anden måde gør dem klar til brug, kan man risikere, at den relevante information ikke følger med det enkelte produkt.



Hvis man på klinikken selv overhælder materiale fra originalemballagen til en anden emballage, skal man sikre sig, at information om indhold, holdbarhed og krav til opbevaring også fremgår af den nye emballage.

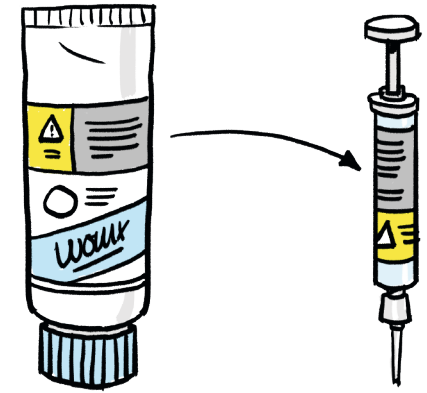

En sikker metode til at holde styr på indhold og holdbarhed er at sikre at emballagen er påført en mærkat med information om indhold, holdbarhed og krav til opbevaring.

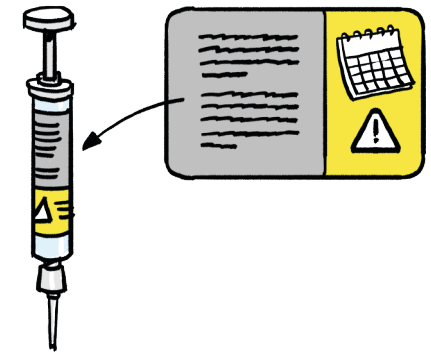

Man kan kombinere ovenstående metode med at placere en mærkat i de skuffer eller skabe, hvor man placerer produkterne, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder, hvor lang holdbarheden er, og hvilke krav der stilles til opbevaring. Anvender man denne metode, skal man være sikker på, at man kan skelne materialerne fra hinanden, når de tages op af skuffen og lægges på behandlingsbakken.

